




土壤纤维素酶 (S-CL) 活性检测试剂盒
Soil Cellulase (S-CL) Activity Assay Kit



北京盒子生工科技有限公司
Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

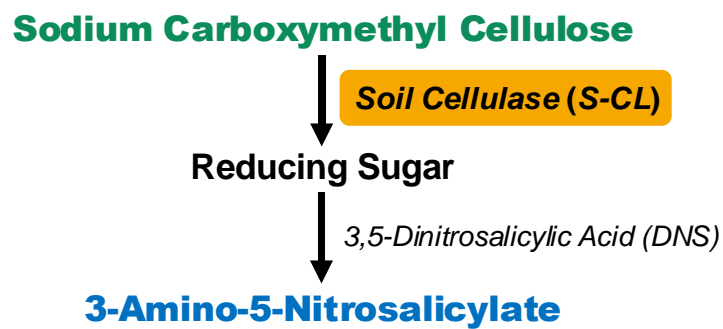

土壤纤维素酶 (S-CL) 活性检测试剂盒

Soil Cellulase (S-CL) Activity Assay Kit

一、产品描述

土壤纤维素酶 (S-CL) 主要来源于土壤微生物, 催化秸秆纤维中 β -1,4-葡萄糖苷键, 使其转变为纤维二糖和葡萄糖, 产物为微生物可优先利用的碳源营养物质, 在土壤碳素代谢中起着重要的作用。

土壤纤维素酶可催化纤维素降解产生还原糖, 进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应, 生成棕红色氨基化合物, 产物在 540 nm 处具有特征吸收峰, 通过吸光值变化即可表征土壤纤维素酶的活性。

二、产品内容

名称	试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
试剂一	甲苯 3 mL×1 瓶	4°C保存	自备试剂
试剂二	液体 6 mL×1 瓶	4°C保存	-
试剂三	液体 25 mL×1 瓶	4°C保存	-
试剂四	液体 5 mL×1 瓶	4°C避光保存	-
标准品	粉剂×1 支 (10 mg 葡萄糖标准品)	4°C保存	使用前加入 1 mL 蒸馏水充分溶解 (即为 10 mg/mL 葡萄糖标准液)
标准稀释液的制备 (现用现配): 使用前将 10 mg/mL 葡萄糖标准液使用蒸馏水稀释至 3.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.25 mg/mL 即为标准稀释液。			

需自备试剂: 甲苯 (C_7H_8 , MW=92.14, CAS:108-88-3)

序号	1	2	3	4	5	6
稀释前浓度 (mg/mL)	10	10	10	10	1.0	0.5
标准液体积 (μ L)	150	100	60	50	200	200
蒸馏水体积 (μ L)	350	400	340	450	200	200
稀释后浓度 (mg/mL)	3.0	2.0	1.5	1.0	0.5	0.25

三、产品使用说明

测定过程中所需要的仪器和试剂: 酶标仪、96 孔板、可调式移液器、恒温水浴/培养箱、烘箱、30-50 目筛、甲苯和蒸馏水。

1. 土壤样本处理

新鲜土样自然风干或 37°C 烘箱风干，过 30-50 目筛。

2. 测定步骤

① 酶标仪预热 30 min 以上，调节波长至 540 nm。

② 在离心管中依次加入下列试剂（可根据预实验结果适当调整样本量）：

试剂	测定管 (μL)	对照管 (μL)	标准管 (μL)	空白管 (μL)
风干土样 (mg)	50	50	-	-
试剂一	25	25	-	-
测定管振荡混匀，室温放置 15 min				
对照管振荡混匀，沸水浴处理 15 min，冷却至室温				
试剂二	50	50	-	-
试剂三	200	200	-	-
蒸馏水	50	50	-	-
① 充分振荡混匀，40°C 水浴糖化 1 h				
② 立即沸水浴处理 15 min，冷却至室温；				
③ 8000 g 常温离心 10 min，取上清即为糖化液；				
糖化液	10	10	-	-
标准稀释液	-	-	10	-
蒸馏水	-	-	-	10
试剂四	30	30	30	30
充分混匀，沸水浴显色 15 min，冷却至室温				
蒸馏水	200	200	200	200

注：沸水浴处理过程注意密封以防止水分散失。

吸光值测定：吸取 200 μL 反应液至 96 孔板中，测定 540 nm 处吸光值，记为 A 测定、A 对照、A 标准和 A 空白；计算 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。注：每个样本均需设一个对照管，各浓度标准管和空白管只需测定 1-2 次。

标准曲线的建立：以 3.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.25 mg/mL 为横坐标 (x)，以其对应的 $\Delta A_{\text{标准}}$ 为纵坐标 (y)，绘制标准曲线，得到线性回归方程 $y = kx + b$ ，将 $\Delta A_{\text{测定}}$ 带入公式中得到 x (mg/mL)。

3.土壤纤维素酶 (S-CL) 活性计算

单位定义：每天每 g 土样中生成 1 mg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$S-CL (U/g) = \frac{x \times V_{\text{反总}}}{W \times T} = \frac{7.8 \times x}{W}$$

注释：V 反总：酶促反应总体积：0.325 mL；T：反应时间，1 h=1/24 d；W：样本质量，0.05 g。

四、注意事项

①若 A 测定或ΔA 测定超出标准吸光值线性范围：高于最高值建议将糖化液使用蒸馏水适当稀释后再进行测定；低于最低值建议适当延长糖化时间或增加样本量后再进行测定，计算时相应修改；

②为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系。

For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.

boxbio

Manufactured and Distributed by

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

Liaodong U Valley, Tongzhou District, Beijing, China

TEL: 400-805-8228

E-MAIL: techsupport@boxbio.cn

Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

